



Zastrzeża się prawo drobnych zmian w układzie.

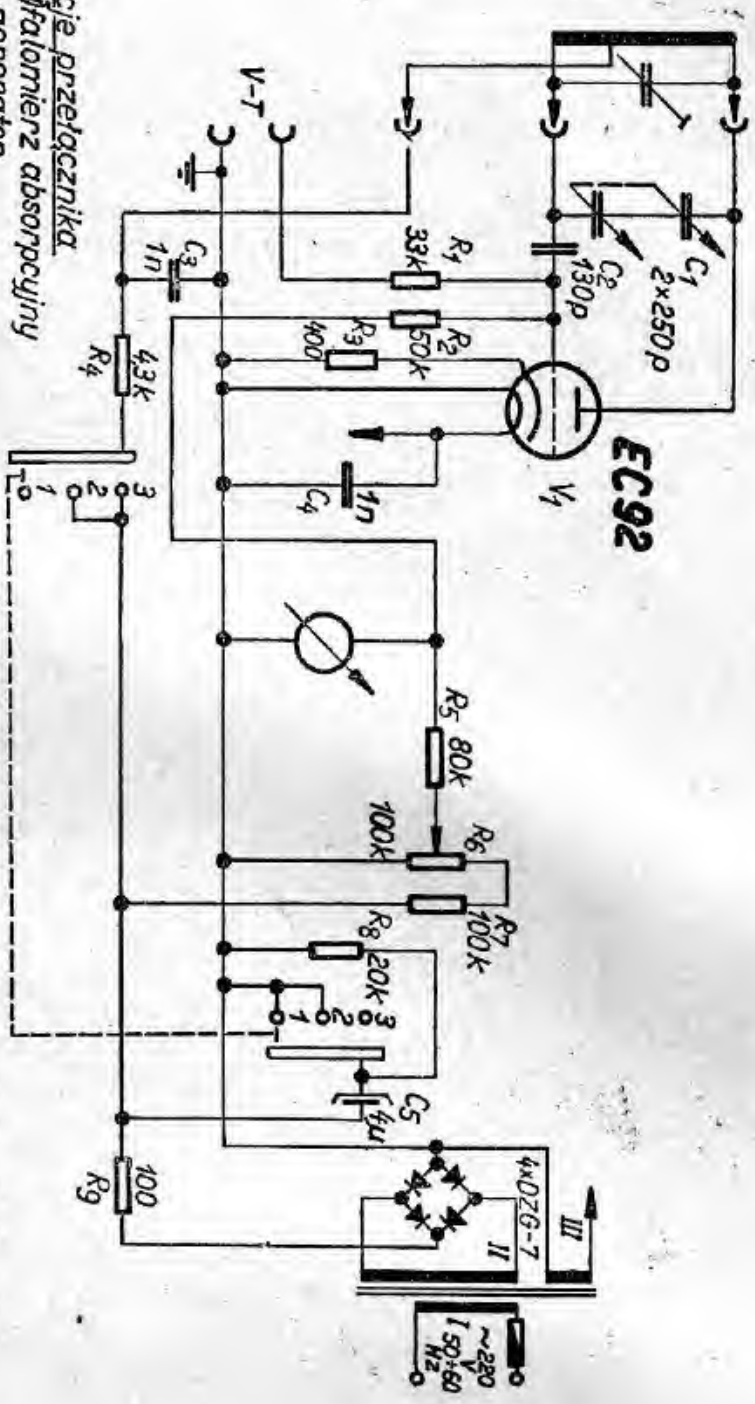

- pozycje przełącznika
- 1. FA (Wyfalomierz absorpcyjny)
 - 2. G - generator
 - 3. AM - generator z amplitudą modulowaną - 100 Hz.

Rys. 1. Falomierz-generator typ RFG-2

Zastrzeżona jest możliwość drobnych zmian w układzie.

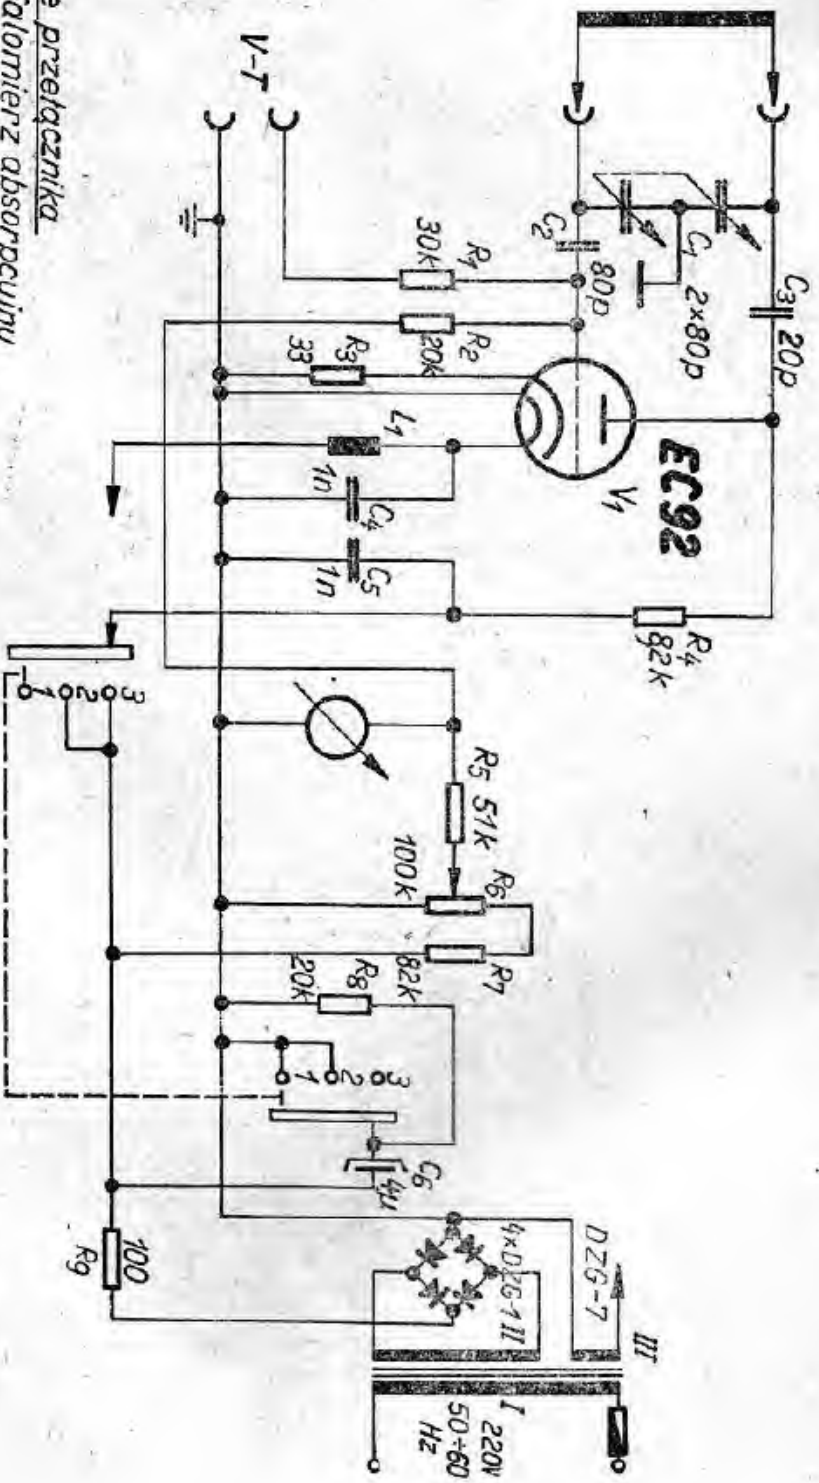

- Pozycje przełącznika
1. FA(VM) falomierz absorpcyjny
 2. G – generator
 3. AM – generator z amplitudą modulowaną – 100 Hz.

Rys. 2. Falomierz-generator typ UFG-2